



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Број: 564/1-01

Датум: 18.5.2018.
Н И Ш

Поштовани,

Дана 17.05.2018. године, потенцијални понуђач нам је поставио питање везано за партију 3 (Центрифуга) у поступку јавне набавке МД-07/018 - набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

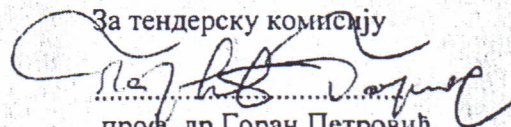
Питање понуђача:

1. Да ли је прихватљиво понудити један ротор који садржи обе конфигурације, односно ротор капацитета 12 x 15ml + 6 x 50 ml са одговарајућим траженим адаптерима, а обзиром да би између осталог обезбедио неупоредиво комфорнији рад јер би корисник потпуно избегао замену ротора при потреби рада са различитим епруветама?
2. На које епрувете од 2 ml се мисли? Ependorf mikrotube или неке другог облика, нпр. епрувете за крв?
3. На које епрувете од 15 ml се мисли? Да ли је одговарајућ капацитет за епрувету димензија 7x110 mm?

Одговор:

1. Није прихватљиво понудити центрифугу са једним ротором, с обзиром да је техничком спецификацијом за партију три стриктно наведено да је неопходно понудити центрифугу са ротором 12 x 15 ml са адаптерима за кивете од 7 ml и 2 ml и ротор 6 x 50 ml са адаптерима за кивете од 30 ml.
2. Мисли се на епрувете типа Ependorf mikrotube.
3. За све тражене запремине битан је спољашњи пречник епрувета-кивета како би се могла користити стандардно лабораторијско посуђе. Епрувете од 15 ml морају бити пречника \varnothing 15 mm, док дужина може бити нешто већа или мања од 110 mm обзиром на разлике у погледу облика и дебљине зидова. Епрувете 7 x 110 mm не могу имати запремину 15 ml.

МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНИ ОДГОВОР И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.

За тендерску комисију

проф. др Горан Петровић